

INSTRUCTIONS POUR FAIRE LE PRÉLÈVEMENT



Lisez toutes les instructions avant de commencer.



Vous pouvez regarder la vidéo des instructions à clsa-elcv.ca/fr/prelevement-a-domicile




Au besoin, demandez à quelqu'un de vous aider.



Pour obtenir de l'aide, contactez-nous au 1-866-999-8303

Étape 1 : SORTEZ le contenu du kit

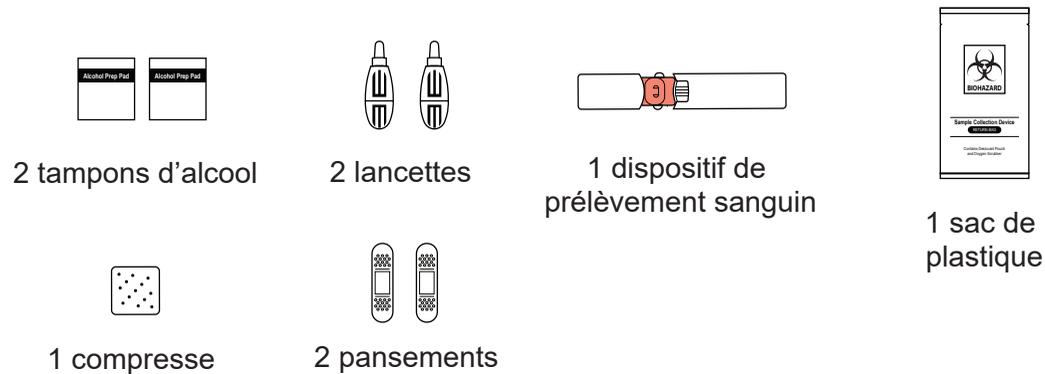


 Contactez-nous s'il manque du matériel.

Étape 2 : PRÉPAREZ le prélèvement

Activez la circulation sanguine jusqu'au bout de vos doigts



RÉCHAUFFEZ vos doigts en vous frottant les mains sous l'eau tiède.



MASSEZ VOTRE ANNULAIRE de la paume à la moitié du doigt.


Désinfectez votre doigt



ESSUYEZ le bout de votre ANNULAIRE avec le tampon d'alcool. * Vous pouvez utiliser votre majeur si vous ne parvenez pas à utiliser votre annulaire.

 N'utilisez pas un doigt qui ne semble pas sain, qui est blessé, enflé, cicatrisé ou couvert d'une éruption cutanée.

Étape 3 : PIQUEZ le doigt et PRÉLEVEZ le sang

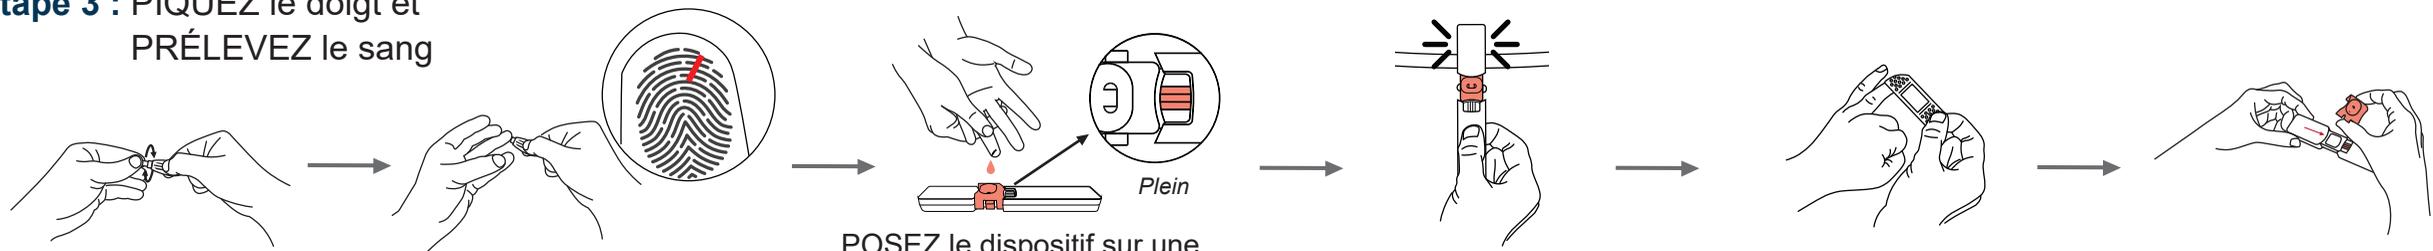

TOURNEZ et RETIREZ le capuchon de la lancette.

PLACEZ la lancette sur la partie charnue entre le milieu et le côté du doigt. APPUYEZ fermement sur la lancette pour couper la peau.

POSEZ le dispositif sur une surface dure. FAITES TOMBER le sang verticalement dans l'entonnoir rouge jusqu'à ce que la fenêtre soit pleine (4 à 5 gouttes). Pour augmenter le flux sanguin, massez de la paume à la moitié du doigt.

Si le sang ne coule pas dans l'entonnoir, TAPOTEZ doucement le dispositif.

ESSUYEZ l'excès de sang sur votre doigt avec la compresse. APPLIQUEZ le pansement.

RETIREZ l'entonnoir rouge. FERMEZ le dispositif en poussant les extrémités l'une vers l'autre.

 RÉPÉTEZ la procédure avec votre majeur s'il n'y a pas assez de sang pour remplir le dispositif.

Étape 4 : EMBALLEZ le dispositif pour le retourner




INSÉREZ le dispositif dans le sac et scellez ce dernier.




Date: 2020/11/29
YYYY/MM/DD AAAA/MM/JJ

Time/Heure: 10:15 AM or PM
HH:MM

ÉCRIVEZ la date et l'heure du prélèvement sanguin sur l'étiquette.



CONSULTEZ la feuille d'instructions pour l'expédition.



Jetez tous les déchets à la poubelle.

Description du dispositif

Le kit de prélèvement contient un dispositif de prélèvement, une lancette, des tampons d'alcool pour nettoyer le bout du doigt et du matériel pour retourner l'échantillon au lieu d'analyse.

Utilisation prévue

Le dispositif est destiné au prélèvement, à la séparation, au stockage et au transport d'un échantillon de sang entier pour le diagnostic in vitro par un utilisateur non professionnel ou un professionnel de la santé. Le dispositif est à usage unique et ne doit pas être réutilisé.

Mode de fonctionnement

L'échantillon de sang est prélevé dans les trois tubes capillaires situés près de l'entonnoir du dispositif de prélèvement. Pour prélever l'échantillon, une lancette stérile est placée contre la peau de l'annulaire. En appuyant fermement, la gâchette s'active et l'aiguille perce la peau du doigt. Le sang est versé dans l'entonnoir rouge du dispositif jusqu'à ce que les trois tubes soient pleins. De 4 à 5 gouttes de sang sont généralement nécessaires. Une fois les tubes remplis, l'entonnoir est retiré et le dispositif est fermé. Par la suite, le dispositif est placé dans le sac de retour. Dans les 24 heures, il est retourné à l'étude pour analyse dans l'enveloppe de retour préadressée fournie.

 Boston Microfluidics | 125 Cambridgepark Drive | Cambridge, MA 02140

Caractéristiques de performance

Le dispositif de prélèvement est conçu pour prélever environ 180 ul de sang entier. Grâce à la séparation des globules rouges et du plasma, les échantillons sont stables pendant sept jours à température ambiante.

Avertissements et précautions

- Ne pas utiliser si l'utilisateur a un problème de coagulation. Utiliser avant la date d'expiration inscrite sur la boîte.
- Ne pas utiliser si la boîte est endommagée.
- Usage unique seulement.
- Pour diagnostic in vitro seulement.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Pour usage externe seulement.
- Une légère ecchymose peut apparaître autour du site de prélèvement.
- Destiné à un usage personnel ou par un professionnel de la santé.
- Faire le prélèvement en position assise pour prévenir tout évanouissement qui pourrait survenir lors du prélèvement.
- Signaler tout incident grave en lien avec le dispositif au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'utilisateur est établi.

Stockage et stabilité

Le dispositif doit être conservé à température ambiante entre 15 °C et 30 °C (59 °F et 86 °F) et peut être utilisé jusqu'à la date d'expiration. Les échantillons doivent être expédiés à température ambiante dans le matériel d'expédition fourni.

Pour nous contacter :

info@clsa-elcv.ca
1-866-999-8303

Étude longitudinale canadienne sur le vieillissement (ÉLCV)
McMaster Innovation Park
Suite B20 — 175 Longwood Rd. S.
Hamilton ON L8P 0A1

Symboles



Fabricant



Ne pas utiliser si la boîte est endommagée



Consulter le mode d'emploi



Ne pas réutiliser



Conserver entre 15 et 30 °C



Date d'expiration



Numéro de catalogue



Code de lot



Attention
Contient des
objets tranchants



Dispositif de diagnostic in vitro



Numéro de série